

投標標封

寄件者：

廠商名稱：

廠商地址：

連絡電話：

廠商統編：



收件者：

**406**

台中市北屯區經貿路一段**100**號

中國醫藥大學郵政代辦所

標案案號：總採字第 115A020411號

標案名稱：BSL-II實驗室儀器案



中國醫藥大學採購規格表

項次	品名	詳細規格	數量
1	-86 超低溫冷凍櫃	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因應空間限制，須為臥式(上掀式開門)，內部需具保溫上蓋。</li> <li>2. 因應空間限制，外尺寸：558(寬) x 688(深) x 993(高) mm ±2cm</li> <li>3. 內尺寸：405(寬) x 490(深) x 426(高) mm，有效容積可達84公升或更佳</li> <li>4. 可存放2英吋儲存盒至少可放置42個或更佳</li> <li>5. 溫度控制範圍：-40 ~ -90℃。</li> <li>6. 外部材質：烤漆鋼板。</li> <li>7. 隔熱材料：硬質聚氨酯整體VIP (Vacuum Insulation Panel) 真空發泡壁板</li> <li>8. 壓縮機：密閉式550W，冷媒採用HC冷媒。</li> <li>9. 溫度控制器：OLED微電腦式控制面板，數字顯示，並可查閱溫度記錄圖表(溫度可選擇紀錄間格時間1~15分鐘)</li> <li>10. 警報系統需具備：高低溫警報、停電警報、遠端警報接點，警報系統蓄電池及散熱風扇運作年限監視警告。</li> <li>11. 上蓋具門扣鎖且四周具有磁吸式邊條，減少冷空氣洩漏。</li> <li>12. 具備USB輸出，可下載溫度及警報數據</li> <li>13. 確校孔：2個(底部*1，背部*1)。</li> <li>14. 腳輪：4個，需具水平調整角*2個。</li> <li>15. 電源供應：AC115V / 60Hz。</li> </ol>	1
2	二氧化碳培養箱	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 直熱式加熱恆溫方式</li> <li>2. 需採90度濕熱方式進行滅菌，並可於15小時完成滅菌與乾燥</li> <li>3. 外觀需具備抗菌塗層(如 ISOCIDE™)，降低外部汙染</li> <li>4. 外部尺寸(寬 x 深 x 高)：500 x 500 x 655 (mm) ±2cm</li> <li>5. 內部尺寸(寬 x 深 x 高)：345 x 375 x 388 (mm) ±2cm，內容積需至少50公升，或更佳</li> <li>6. 主體：為1.2 mm/18- gauge 鍍鋅鋼板，艙體內採304不鏽鋼板</li> <li>7. 層架材質需採：為1.5 mm/18- gauge 304不鏽鋼板，至少具備三片層架</li> <li>8. 溫度可控制範圍：環境溫度+5~60℃</li> <li>9. 採內高溫紅外線二氧化碳感測器，CO2控制範圍：0~19.5%</li> <li>10. 溫度回復時間(在開門30秒後)：≤5分鐘；CO2回復時間(在開門30秒後)：≤6分鐘 或更佳</li> <li>11. 面板採LCD數位顯示，可查閱溫度與CO2、滅菌溫度之歷史紀錄變化數據</li> <li>12. 電力功率：110-130 VAC，50/60 Hz，1 Ø</li> </ol>	1
3	三尺生物安全操作櫃	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 系統可設定LED照明亮度，配合使用者使用習慣</li> <li>2. 可透過面板設定UV燈之照明時間</li> <li>3. 採變頻馬達，節省能源，並搭配風壓感知器隨時調整艙內風流，確保維持艙內之風流安全。</li> <li>4. 表面需具備抗菌塗層，降低日後環境造成發霉發生機率，保障環境、培養樣品的安全性，並具備原廠測試數據佐證</li> <li>5. 空氣過濾材質需採可過濾99.999%大於0.3µ的微小顆粒為佳，使</li> </ol>	1

	<p>           艙內可維持 ISO Class 3 等級之潔淨程度            6. 前窗傾斜 10 度，符合操作者的視覺角度            7. 使用數據可自動記錄，並可透過 USB 進行資料傳輸            8. 外部尺寸需符合 1035 x850x1400mm ±2cm（不含鐵架）            9. 操作區域採 304 不銹鋼材質設計            10. 採液晶觸控螢幕設計，當風量出現異常時會即時透過視覺與聽覺進行警報，無需再按按鍵才可得知風量訊息，並可符合 21 CFR Part 11 軟體設計，完整記錄使用狀況、權限分級。            11. 可設定關閉櫥窗前之延遲關閉功能，讓艙內空氣可以再關閉前進行過濾循環            12. 操作台採可調整水平與便於隨時移動之輪座            13. 具 NSF 49 認證            14. 具待機模式，讓艙內於待機時能夠保持潔淨度            15. 具預篩濾網，可防止大顆粒髒污進入管道間，延長濾材壽命            16. 具可調式底座鐵架，可調整 17.5cm~91.5cm，間距 50mm         </p>	
<p>           一、履約期限：決標後 <u>90</u> 日內。            二、保固年限：提供保固，自驗收合格之日起 <u>2</u> 年。         </p>		

**備註:**

1. 規格含以上或同等品以上之規格(若規格無可視之功能，則以產品型錄加以佐證之)。報價設備尺寸容許誤差，廠商務必自行確認。
2. 廠商投標時請檢附設備之型錄正本或影本，以供審查其規格是否符合條件。並加蓋投標廠商及負責人印章，若為外文型錄需譯為中文。投標送審之型錄請自行驗證，開標當時不得補件，若提供之資料不夠詳細，以至本單位無法正確審查時，視為規格不符處理，投標廠商不得異議。
3. 本案執行期間如有變更，承攬商需配合辦理相關事宜，保固期依規格表規定之保固年限。
4. 廠商報價金額均為含稅價，包含勞工投保意外保險、加值型營業稅、管理及利潤等費用。
5. 本案如須配合吊運、定位、安裝工程，採責任施工請務必自行赴施工地點詳實勘查，俾以明瞭本工程一切有關事項，並對運輸、工棚、儲料及用水用電等有所安置，投標後不得提出任何異議或藉詞要求加價，施工期間一切水電等設備及所需費用概由得標人自理。
6. 校方提供現場水電、網路線路等插座點位置，廠商須自行拉設相關電源至定位，確保設備正常運作。





# 投 標 廠 商 聲 明 書

本廠商參加中國醫藥大學招標採購 BSL-II 實驗室儀器案之投標，茲聲明如下：

項次	聲明事項	是(打V)	否(打V)
一	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。		
二	本廠商有違反政府採購法(以下簡稱採購法)施行細則第 33 條之情形。		
三	本廠商是採購法第 38 條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。		
四	本廠商之負責人或合夥人是採購法第 39 條第 2 項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。		
五	本廠商是採購法第 39 條第 3 項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。		
六	本廠商已有或將有採購法第 59 條第 1 項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他不正利益為條件，促成採購契約之成立之情形。		
七	本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第 103 條第 1 項、採購法施行細則第 38 條第 1 項、人口販運防制法第 41 條所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至政府電子採購網 web.pcc.gov.tw 查詢自己(包括總公司及各分公司)、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第 103 條第 1 項之拒絕往來廠商】		
八	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第 2 條及第 3 條所稱公職人員或其關係人。		

九	<p>本廠商是依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業。(依該認定標準第 2 條，所稱中小企業，指依法辦理公司、有限合夥或商業登記，實收資本額或出資額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業。)</p> <p>(答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫)</p> <p>項目 _____ 金額 _____</p> <p>項目 _____ 金額 _____</p> <p style="text-align: center;">合計金額 _____</p>		
十	<p>本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾 100 人。(依採購法第 98 條及其施行細則第 107 條、108 條規定，得標廠商其於國內員工總人數逾 100 人者，應於履約期間僱用身心障礙者及原住民各不低於總人數百分之一，僱用不足者，除應繳納代金，並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。)</p> <p>(答「是」者，請填目前總人數計 _____ 人；其中屬於身心障礙人士計 _____ 人，原住民計 _____ 人。)</p>		

十一	<p>本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或經濟部(投資審議司)公告之陸資資訊服務業者，不得從事經濟部(投資審議司)公告之「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」。【上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於政府電子採購網 web.pcc.gov.tw&gt;首頁&gt;相關連結&gt;其他經濟部投審司公告陸資資訊】請查察招標文件規定本採購是否屬經濟部(投資審議司)公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購】</p>		
十二	<p>本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或在臺陸資廠商，不得從事影響國家安全之採購。【請查察招標文件規定本採購是否屬影響國家安全之採購】</p>		

十三	<p>本廠商是原住民個人或政府立案之原住民團體。</p> <p>(答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之項目及金額，可自備附件填寫。如無，得填寫「0」)</p> <p>項目 _____ 金額 _____</p> <p>項目 _____ 金額 _____</p> <p>合計金額 _____</p>		
----	--	--	--

<p>附註</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第一項至第七項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。</li> <li>2. 本採購如非屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，第八項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象【違反公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 1 項規定者，依同法第 18 條第 1 項處罰】。如屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，答「是」、「否」或未答者，均可。</li> <li>3. 第九項、第十項、第十三項未填者，機關得洽廠商澄清。</li> <li>4. 本採購如屬經濟部(投資審議司)公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，第十一項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。</li> <li>5. 本採購如屬影響國家安全之採購，第十二項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。</li> <li>6. 本聲明書填妥後附於投標文件遞送。</li> <li>7. 本採購如屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，且本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第 2 條及第 3 條所稱公職人員或其關係人者，請填「公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項公職人員及關係人身分關係揭露表」，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第 18 條第 3 項處罰。</li> </ol>
	<p>投標廠商名稱：</p>
	<p>投標廠商負責人<u>簽名或蓋章</u>： 日期：</p>

(114.6.4 版)

## 委託代理授權書

本廠商投標

案 號：115A020411

標案名稱：BSL-II 實驗室儀器案

茲授權下列代理人全權代理本廠商參加開標、行使議比價、領退回押標金、說明等事項，恐口無憑，特立委託書一紙為據。

本授權書自簽發之日起生效

此致

中國醫藥大學



委託廠商：

負 責 人：

地 址：

電 話：

統 編：

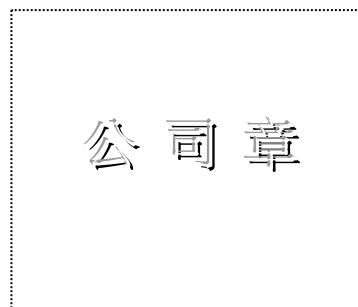

代理人姓名：

身分證字號：

中國醫藥大學為辦理招標作業之目的，本表單所蒐集之個人資訊，將僅作為招標作業之用。 您得本招標公告聯絡方式行使查閱、更正等個人資料保護法第 3 條的當事人權利。如您提供的資料不 完整或不確實，將可能無法完成本次申請。

中 華 民 國 年 月 日