


投標標封

寄件者：

廠商名稱：_____
廠商地址：_____
連絡電話：_____
廠商統編：_____

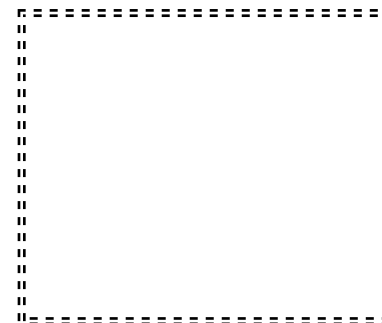

收件者：

406

台中市北屯區經貿路一段100號

中國醫藥大學郵政代辦所

標案案號：**115A090050**

標案名稱：冷凍櫃。

中國醫藥大學招標文件審查表

(文件請依表列順序排放並將本表置於首頁)

採購名稱及案號	冷凍櫃(115A090050)		
廠商名稱		廠商統編	
投標應附之文件	審 查 結 果		不合格原因 (由資格審查人員填具)
	合 格	不 合 格	
☐ 押標金 元			
☒ 公司設立登記文件(請至經濟部或財政部網頁下載) (如公司登記或商業登記證明文件,非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機關核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。)			
☐ 廠商納稅之證明 稅捐機關核發之最近一期營業稅完稅證明。(廠商不及提出最近一期證明者,得以前一期之納稅證明代之。)			
☐ 最近半年內之無退票證明文件(如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等。)			
☐ 廠商聲明書			
☒ 非負責人出席時檢附授權書			
☒ 報價單			
☒ 報價詳細廠牌型號規格內容(報價廠牌、型號、型錄等)			
☐ 契約書草約			
☐ 其他: (與履約能力有關之基本資格文件)			
資格審查結果	☐ 合格	☐ 不合格	審查人員簽名:
規格審查結果 (報價詳細廠牌型號規格內容)	☐ 合格	☐ 不合格 不合格原因:(由規格審查人員填具)	審查人員簽名:
審查結果	☐ 合格 ☐ 不合格		

※本審查表為開標作業審查用,請廠商務必填妥粗框內資料並檢附於投標文件中 114.09 修訂

本標案規格

中國醫藥大學採購規格確認表

項次	品名	詳細規格	數量
1	-20℃~-30℃ 生物醫學冷凍櫃	1. 外尺寸：因場地受限，外部尺寸需 ≤ 770 W x 830 D x 1955 H (mm) 2. 內尺寸：因使用需求，內部尺寸需 ≥ 650 W x 700 D x 1520 H (mm) 3. 有效容積：至少690公升 4. 外部材質：塗漆鋼板，可降低生鏽機率。 5. 外門：塗漆鋼板，可避免環境濕氣生鏽狀況。 5. 內腔：拋光鋼板，可避免生鏽狀況。 6. 隔熱材質：硬質聚氨酯成形發泡，保溫性較佳。 7. 擱板：4個（每個擱板最大承受重量50公斤） 8. 通道孔：2個（直徑30 mm），機器上方和左側各1個 9. 門鎖：1個 10. 腳輪：4個，附2個固定水平腳 11. 冷卻方式：直冷式 12. 壓縮機：密閉式，輸出功率450W 13. 除霜：可手動不斷電除霜系統 14. 電源供應：AC115V / 60Hz 15. 溫度控制：微電腦處理控制模式 16. 溫度範圍：-20℃到-30℃ 17. 溫度顯示：數位顯示 18. 警報：斷電警報，高/低溫警報，門未關妥警報，遠端警報接點，壓縮機溫度警報，自我診斷 19. 重量：152公斤$\pm$3% 20. 附件：鑰匙2支/組、操作說明書 21. 內建三組溫度 Sensor，除了主控 Sensor 以外，另具除霜感應 Sensor 與壓縮機溫度 Sensor 22. 內建面板備用電池可供主電源斷電狀態下供給面板繼續顯示溫度與執行面板警報等相關功能	1

一、 履約期限：☐決標後____日內。

☒中華民國 115 年 10 月 31 日前。（以日曆天計，星期例假日、國定假日或其他休息日計入）。

☐中華民國____年____月____日起至____年____月____日止。

二、 保固年限：☐不須提供保固。

☒提供保固，自驗收合格之日起 2 年。

委 託 代 理 授 權 書

本廠商投標

採購案號：115A090050

標案名稱：冷凍櫃

茲授權下列代理人全權代理本廠商參加開標、行使議比價、領退回押標金、說明等事項，恐口無憑，特立委託書一紙為據。

本授權書自簽發之日起生效。

此致

中國醫藥大學

委託廠商：

負 責 人：

地 址：

電 話：

統 編：

公 司 章

負 責
人 章

代理人姓名：

身分證字號：

中國醫藥大學為辦理招標作業之目的，本表單所蒐集之個人資料，將僅作為招標作業之用。

您得本招標公告聯絡方式行使查閱、更正等個人資料保護法第3條的當事人權利。如您提供的資料不完整或不確實，將可能無法完成本次申請。

中 華 民 國 年 月 日